

TEST REPORT

委托检测编号: JH20211115

委托单位

江苏特斯特检测技术有限公司

项目名称: 江苏特斯特检测技术有限公司废气排放检测

检测项目: 有组织废气



Jiangsu Test & Test Co., Ltd

说 明

1. 检验检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负责检测技术责任，并对委托单位所

2. 样品和技术资料保密。

3. 本报告仅对来样负责，不得作为法律依据。报告只供本公司检测使用，不得

4. 本报告未经本公司批准，不得部分复制或擅自

5. 由委托单位自行采集的样品，本公司只对该样品检测结果负责，对样品来源负责。

6. 对于无法保存、复现的样品不受理申诉。

7. 未经同意，报告不得用于广告宣传

8. 其他

检测委托受理电话：19979270001

检测服务投诉电话：079286223

传真：0792-8901066

E-mail: zhanhg_jxjh@163.com

中 以：

签发人职位：

授权签字人

(检验检测专用章)



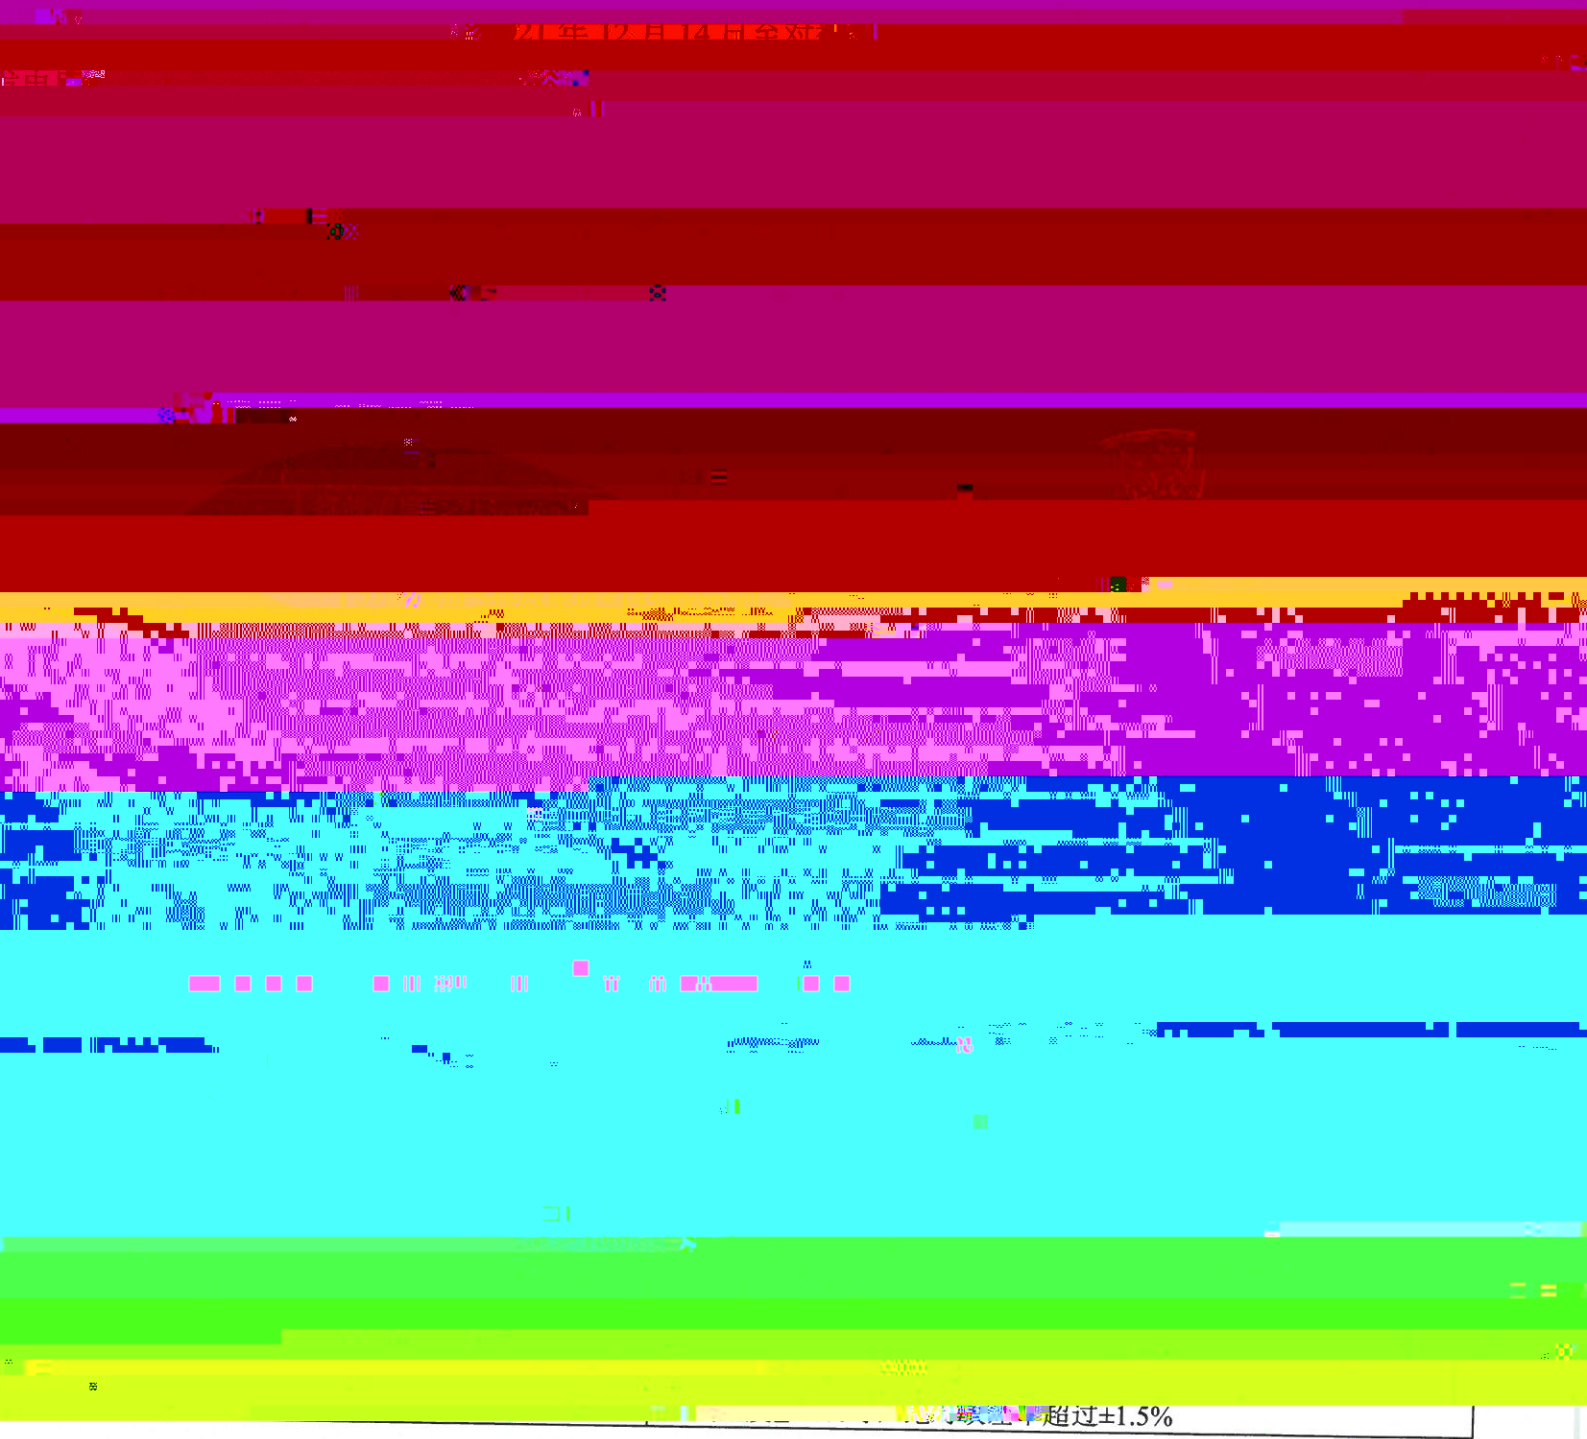


表1 烟气连续监测系统主要仪器型号


表名

表号

CEMS 主要仪器型号						
仪器名称	型号	原理	制造单位			
氧量分析仪	PM50	紫外差分吸收光谱	杭州洛基			
氯化氢	23.763	4.7	mg/m ³	19	绝对误差不超过±17mg/m ³	达标
一氧化氮	0.087	0.3	%	-0.21	绝对误差不超过±1%	达标
烟气流速	3.32	3.35	m/s	0.3	相对误差不超过±25%	达标
温度	21.28	21.55	°C	-0.33	绝对误差不超过±1±3°C	达标
含氧量	10.951	10.9	%	0.47	相对准确度<15%	达标
湿度	21.28	21.55	°C	-0.33	相对误差不超过±25%	达标

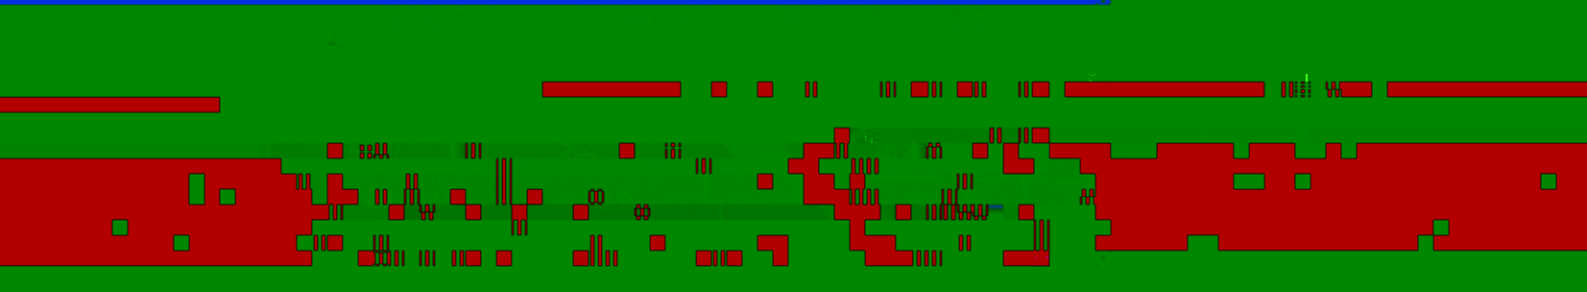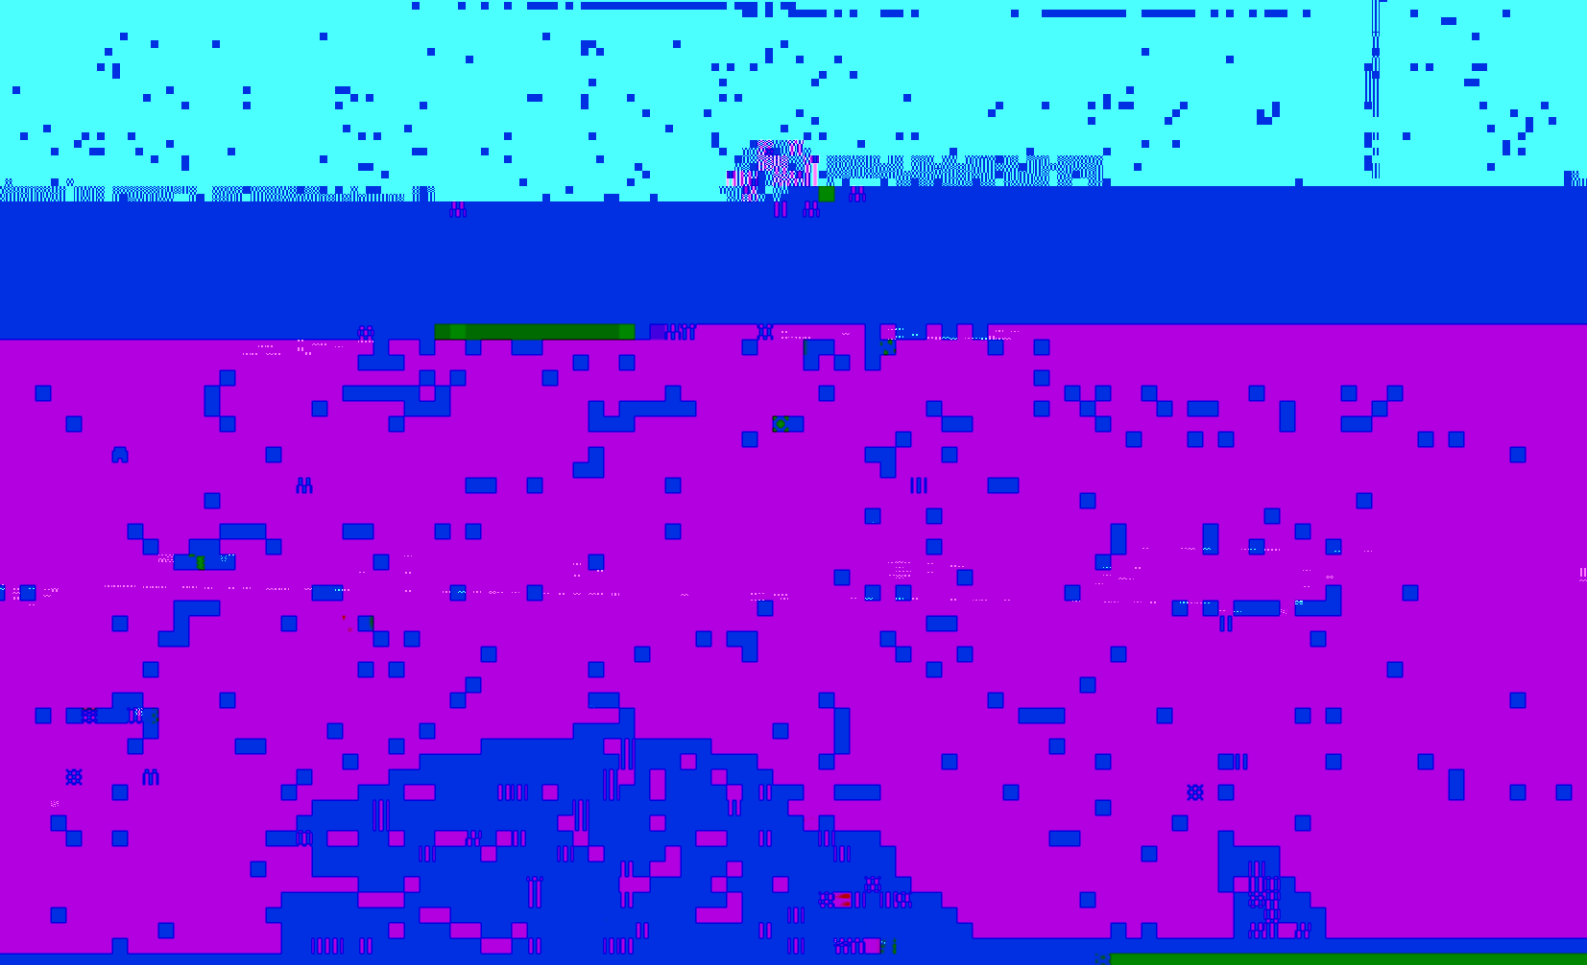

第一次				第二次			
174.253				143.300			
146.9				144.1			
第五次				第五次			
132.930				137.060			
146.9				137.1			
第六次				第六次			
153.1020				141.000			
146.9				141.1			
平均值				平均值			
68.028				140.785			
146.3				141.1			
第一次				第一次			
30.704				0.103			
第二次				第二次			
36.651				0.137			
第三次				第三次			
15.247				0.065			
第四次				第四次			
31.914				0.041			
第五次				第五次			
10.145				0.108			
第六次				第六次			
17.917				0.092			
平均值				平均值			
23.763				0.087			
4.7				0.3			

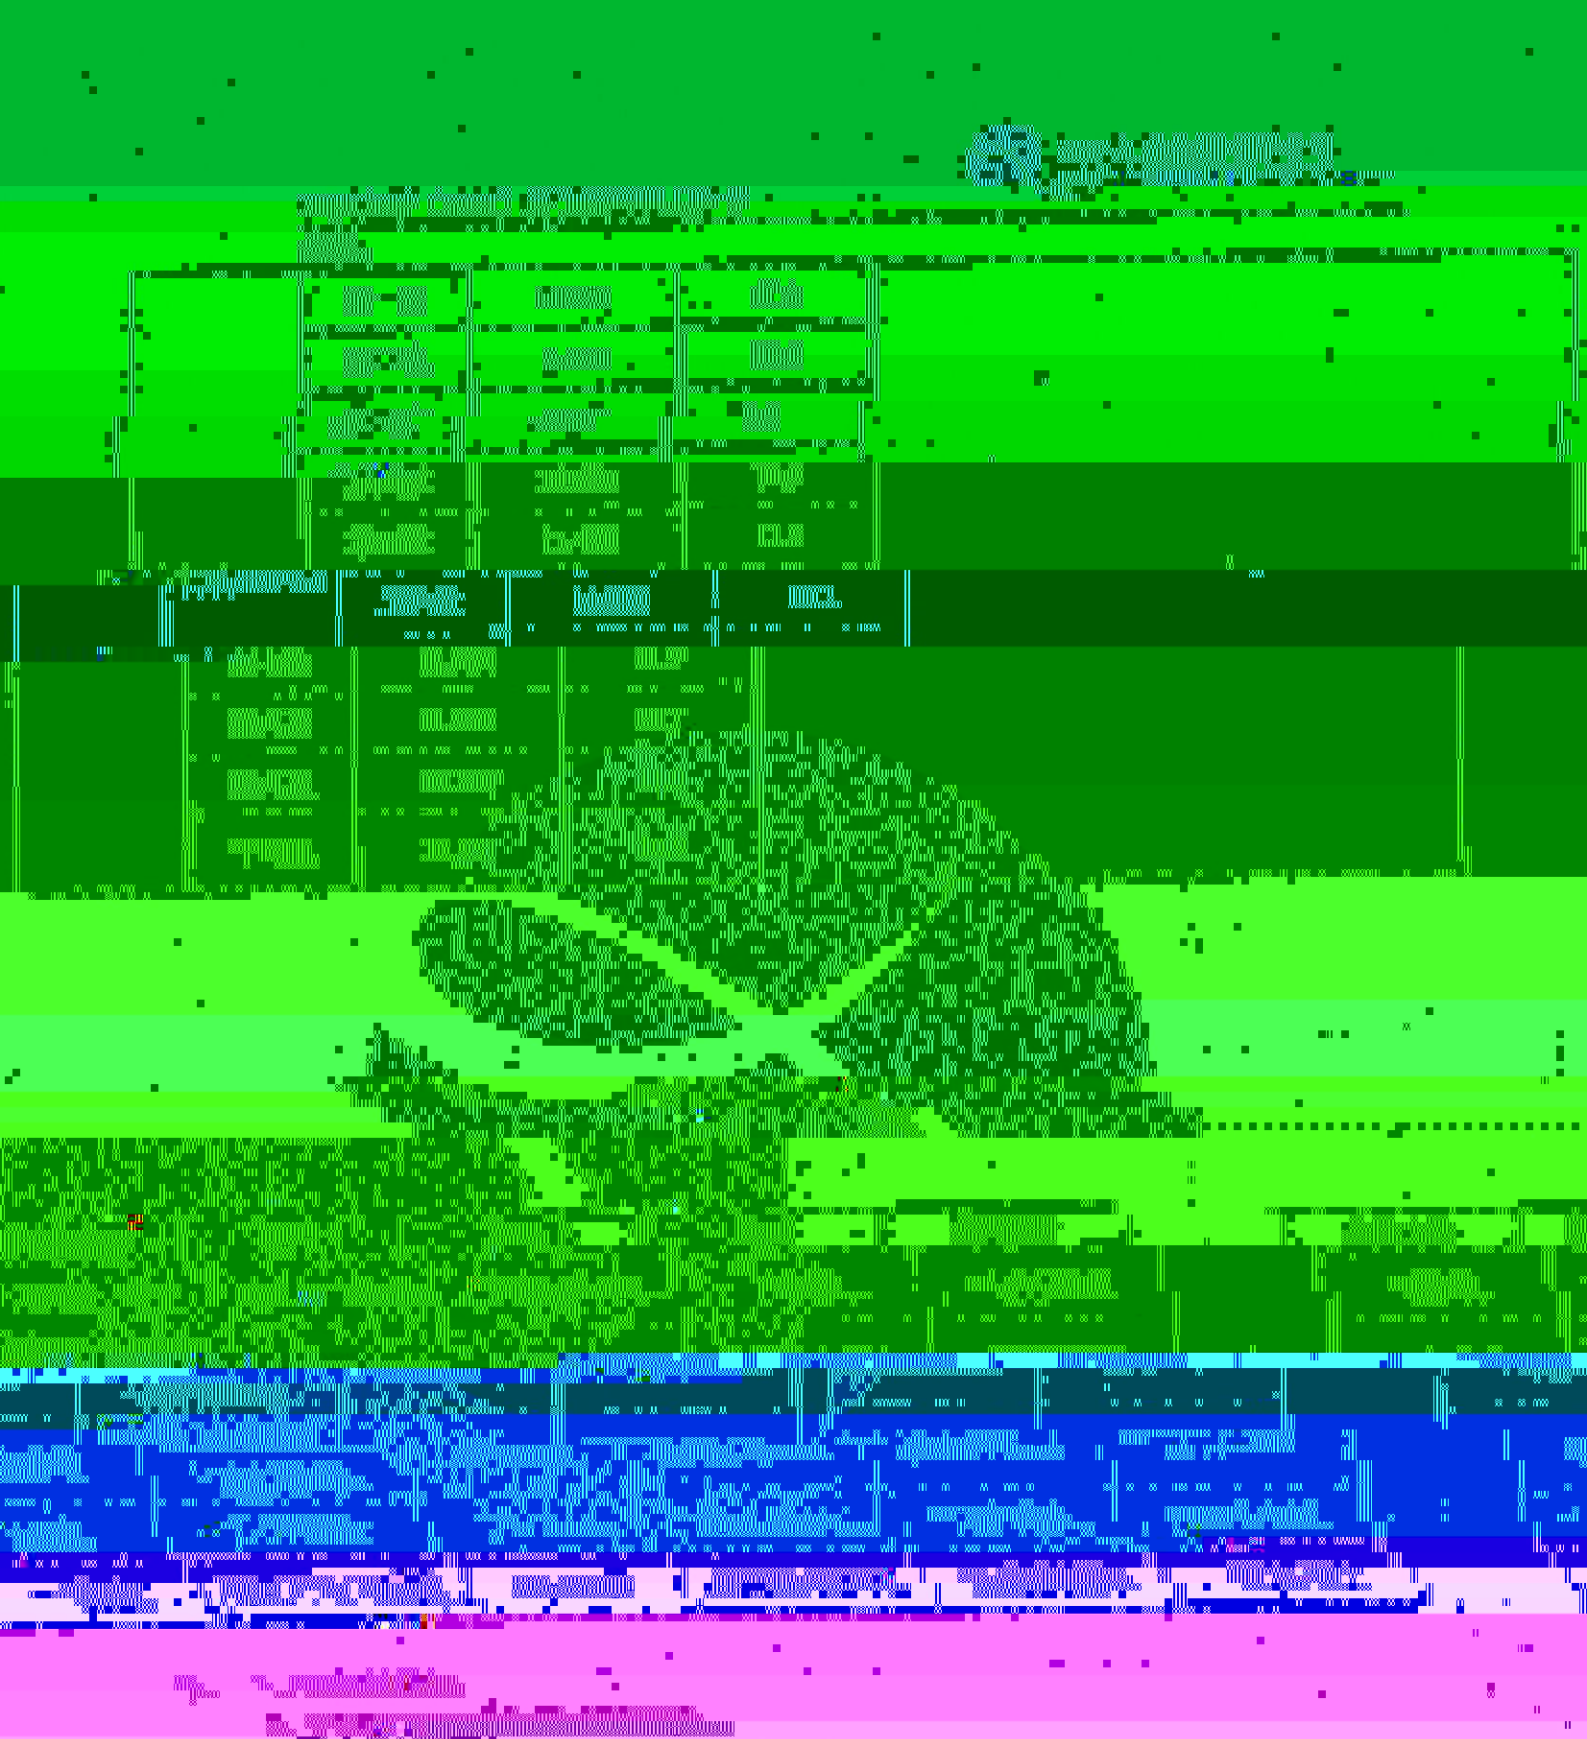

报告结束***